Gebruikershandleiding

Mijn bloedsuiker in Nederland meten
met VitaeChek



Beheer je bloedsuiker:
scan en download de applicatie.

VitaeChek

Bloedglucosebewakingssysteem

Inleiding

Beste eigenaar van het VitaeChek G1 Pro Bloedglucosebewakingssysteem,

* Verwijder de isolatiefolie uit het batterijvak vóór het eerste gebruik.

Bedankt dat u hebt gekozen voor het VitaeChek G1 Pro bloedglucosebewakingssysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met testen begint.

Doel van gebruik

De VitaeChek-teststrips worden gebruikt met de VitaeChek G1 Pro bloedglucosemeter om de hoeveelheid glucose in vers capillair volbloed kwantitatief te meten voor zelftesten.
De bloedglucoseconcentratie van veneus bloed of neonataal bloed kan worden gemeten door zorgprofessionals.
Het verse capillaire volbloed wordt afgenomen uit de vingertop en het neonatale bloed uit de hiel.
Het systeem is bedoeld voor in-vitro diagnostisch gebruik thuis of door zorgprofessionals in een klinische omgeving als hulpmiddel bij het monitoren van de effectiviteit van diabetesbehandeling.
Dit systeem is niet bedoeld voor het stellen van de diagnose van diabetes mellitus..

Testprincipe

De teststrip meet glucose met behulp van amperometrische technologie waarbij een glucosedehydrogenasereactie wordt toegepast.
Wanneer volbloed of controlevloeistof in het uiteinde van de teststrip wordt gezogen, reageert de glucose in het monster met de chemicaliën en ontstaat er een elektrische stroom.
De meter meet deze elektrische stroom en berekent de hoeveelheid glucose.
Het glucose-resultaat wordt weergegeven als een berekende plasmawaarde.

Waarschuwing:
Alleen zorgprofessionals mogen veneuze of neonatale bloedmonsters afnemen en voorbereiden.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Waarschuwing:

- Tijdens normaal gebruik kunnen een bloedglucosemeter of een prikpen in contact komen met bloed. Alle onderdelen van de set worden beschouwd als biologisch gevaarlijk materiaal en kunnen mogelijk infectieziekten overdragen via bloedoverdraagbare pathogenen, zelfs nadat u hebt schoongemaakt en gedesinfecteerd.
- De meter en de prikpen mogen nooit door meer dan één persoon worden gebruikt. Deel de meter en prikpen niet met anderen, ook niet met familieleden, vanwege het risico op infectie door bloedoverdraagbare pathogenen.
- Reiniging en desinfectie van de meter en prikpen vernietigt de meeste, maar niet noodzakelijk alle, bloedoverdraagbare pathogenen.
- Als de meter wordt bediend door een tweede persoon die hulp biedt bij het testen, moeten de meter en prikpen vóór gebruik door deze tweede persoon worden gereinigd en gedesinfecteerd.
- Desinfecteer de meter en prikpen voordat iemand anders ze aanraakt. Laat niemand anders testen met de meter of prikpen.
- Het is belangrijk om de meter en prikpen schoon en gedesinfecteerd te houden. Reinig en desinfecteer de prikpen eenmaal per week om zichtbaar vuil of ander materiaal te verwijderen voor veilig gebruik en/of vóór desinfectie.
- Voor instructies over het reinigen en desinfecteren van de meter en prikpen, zie hoofdstuk Onderhoud.
- Was uw handen grondig vóór en na het hanteren van de meter, prikpen of teststrips.
- Verstikkingsgevaar: kleine onderdelen inbegrepen. Houd uit de buurt van kinderen.
- Sterke elektromagnetische velden kunnen de juiste werking van de meter verstoren. Gebruik deze meter niet in de nabijheid van bronnen van sterke elektromagnetische straling.
- Om elektrostatische ontlading te voorkomen, gebruik de meter niet in een zeer droge omgeving, vooral niet in ruimtes waar synthetische materialen aanwezig zijn.

Belangrijke gezondheidsinformatie

- Patiënten die zuurstoftherapie ondergaan, kunnen onnauwkeurige resultaten krijgen.
- Sommige mensen met diabetes ervaren geen symptomen van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Anderen, zoals kinderen of mensen die bewusteloos zijn of bepaalde beperkingen hebben, kunnen hun symptomen mogelijk niet aan zorgverleners doorgeven. Om deze redenen mag u uw behandeling niet aanpassen zonder eerst uw arts te raadplegen.
- Voer een controletest uit wanneer u een nieuwe doos teststrips opent of als u denkt dat uw testresultaat onjuist is. Een controletest laat u weten of de meter en teststrips correct functioneren.
- VERANDER UW BEHANDELING NIET OP BASIS VAN ÉÉN ENKEL RESULTAAT dat niet overeenkomt met hoe u zich voelt of als u vermoedt dat uw testresultaat onjuist is.
- Als uw bloedglucoseresultaat niet overeenkomt met hoe u zich voelt en u de instructies in deze handleiding hebt gevolgd, volg dan de aanwijzingen van uw arts of neem contact op met uw arts.
- Kinderen moeten worden geleerd hoe ze de meter en andere medische hulpmiddelen op de juiste manier moeten gebruiken.
- Ernstige uitdroging of groot vochtverlies kan leiden tot onjuiste (lage) testresultaten. Als u denkt dat u uitgedroogd bent, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- Als u alle instructies in deze handleiding hebt opgevolgd en nog steeds symptomen hebt die niet overeenkomen met uw testresultaten — of als u vragen hebt — neem dan contact op met uw arts.
- Het systeem is ontworpen voor gebruik met vers capillair volbloed, veneus bloed of neonataal bloed.
- Onnauwkeurige testresultaten kunnen optreden op grote hoogte (meer dan ongeveer 3048 meter boven zeeniveau).
- Bij de BS-602 bloedglucoseteststrip kan een hematocrietwaarde van meer dan 70% de meetresultaten beïnvloeden. Raadpleeg uw arts om uw hematocrietwaarde te laten bepalen.
- Sommige stoffen kunnen valse resultaten veroorzaken bij enzymatische tests.

Beperkingen

De onderstaande interferenties zijn getest en hebben geen merkbare invloed op de resultaten aangetoond bij

Stof	Concentratie	Stof	Concentratie
Acetaminofen	1.11 mmol/L (20 mg/dL)	Ascorbinezuur	0.17 mmol/L (3 mg/dL)
Bilirubine	2.22 mmol/L (40 mg/dL)	Cholesterol	27.78 mmol/L (500 mg/dL)
Creatinine	0.56 mmol/L (10 mg/dL)	Dopamine	1.1 mmol/L (20 mg/dL)
Gentisinezuur	1.25 mmol/L (22.5 mg/dL)	Glutathion	2.17 mmol/L (39 mg/dL)
Hemoglobine	1111.11 mol/L (20000 mg/dL)	Heparine	500 IU/dL
Ibuprofen	2.78 mmol/L (50 mg/dL)	Icodextrine	60.8 mmol/L (1094.4 mg/dL)
L-Dopa	0.03 mmol/L (0.5 mg/dL)	Maltose	555.56 mmol/L (1,0000 mg/dL)
Methyl-DOPA	0.22 mmol/L (4 mg/dL)	Salicylaat	3.33 mmol/L (60 mg/dL)
Tolbutamide	5.55 mmol/L (100 mg/dL)	Tolazamid	0.56 mmol/L (10 mg/dL)
Triglyceriden	83.33 mmol/L (1500 mg/dL)	Urinezuur	1.33 mmol/L (24 mg/dL)
Xylose	2.78 mmol/L (50 mg/dL)	Pralidoxime-jodide	0.83 mmol/L (15 mg/dL)
EDTA	11.11 mmol/L (200 mg/dL)	Galactose	0.83 mmol/L (15 mg/dL)

Andere storende stoffen genoemd in EN ISO 15197:2015, Bijlage A zijn niet geverifieerd en kunnen eveneens de testresultaten beïnvloeden.

Inhoudsopgave

Introduction 2

- Intended Use 2
- Test Principle 2
- Important safety information 3
- Important health-related information 3
- Limitations 4

Table of Contents 5

Getting to know your VitaeChek System 7

- VitaeChek kit Includes 7
- Manufacturer of Lancing Device and Sterile Lancet 8
- VitaeChek Meter 9
- VitaeChek Meter Display 10
- VitaeChek Test Strip 11
- Important Test Strip Information 11
- VitaeChek Lancing device 12
- VitaeChek Lancet 12

Setting up your meter 13

Bluetooth connection 15

- Bluetooth requirements 15

Testing your blood glucose 16

- Preparing the lancing device 16
- Blood sampling 18
- Testing 19
- Interpreting unexpected test results 22

Comparing your meter result to a laboratory result 23

Memory and averages 24

- Storing Blood glucose and Control Test results 24

Control solution testing 25

- When to perform a control test 25
- Performing a control test 26
- Understanding out-of-range control test results 28


Maintenance 29
Replacing the battery 29
Meter maintenance 30
Storing your system 30
Checking for expiration or damage 31
Cleaning and disinfection 31
Cleaning your meter and lancing device 31
Disinfecting Your Meter and Lancing Device 31
Troubleshooting 32
Meter does not enter the test mode after inserting a test strip. 33
Test does not start after applying the blood sample. 33
Technical information 34
Specifications 34
Electromagnetic Compatibility 34
Disposing of the meter, test strips, lancets and batteries 35
Warranty 35
Limited 2 Years Warranty 35
Traceability 35
Performance characteristics 36
Table1. 36
Table2. 36
Table3. 37
Before going to the lab 37
While at the lab 37
Symbol index 38
Appendix 39


Kennismaken met uw VitaeChek-systeem

De VitaeChek-set bevat:





















1.	Meter	6.	Twee AAA-alkalinebatterijen (inbegrepen)
2.	Teststrips	7.	Gebruikershandleiding
3.	Steriele lancet	8.	Snelle startgids
4.	Prikpen	9.	Logboek
5.	Controleoplossing (optioneel)		

Fabrikant van prikpen en steriele lancet

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.
NO.1 Shuangshan Sanjian Road, Zhangqiu, Jinan City, 250200 Shandong, P.R. China

EC REP Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany —
CE:voor prikapparaat; CE 0197 voor steriele lancet

Beijing Ruicheng Medical Supplies Co., Ltd.
No. 558 Zhangzikou, Yangsong Town, Huairou District, 10400 Bejing, China


EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julinaplein 10, le Verd,2595AA, The Hague, Netherlands.
CE:voor prikapparaat; CE 0197 voor steriele lancet

Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.
A01,Plant B, No.278, Hang kong Road ,Tianjin Pilot Free Trade Zone (Air Port Industrial Park),Tianjin 300308, China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
CE:voor prikapparaat; CE 0197 voor steriele lancet

Waarschuwing:
Houd de meter en testmaterialen uit de buurt van kinderen. Kleine onderdelen zoals het batterijdeksel, batterijen, teststrips, lancetten, beschermkapjes van de lancetten en het dopje van de controlevloeistof vormen verstikkingsgevaar.
Het wordt aanbevolen om de glucosemeting binnenshuis uit te voeren.

VitaeChek Meter

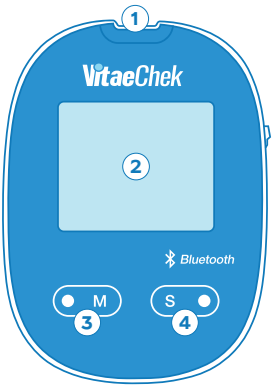

1. Strippoort


Plaats hier de VitaeChek-teststrip.

2. LCD-scherm

Toont uw testresultaten, symbolen en berichten.

3. “M”-knop

4. “S”-knop




5. Batterijdeksel

Voor het veilig verwijderen van gebruikte teststrips.

6. Batterijvak

7. Uitwerpknoop

VitaeChek Meter Display



	Teststripherinnering
	Breng bloedmonster aan-herinnering
MEM	Geheugen
	Temperatuur buiten bereik
	Laag batterijniveau-herinnering
	Testresultaat
mg/dL mmol/L	Meet-eenheid
AM PM	Datum en tijd
	Alarmklok-herinnering
HCT (%)	HCT-resultaat
AVG	Gemiddelde
	Bluetooth

VitaeChek Teststrip



1. Contactbalk

Steek deze in de strippoort. Duw helemaal naar binnen totdat hij niet verder kan.

2. Bovenrand

Breng hier het bloedmonster aan.

3. Controlevenster

Gebied voor het controleren van het monster.


Belangrijk:
De meter mag alleen worden gebruikt met BS-602 teststrips. Het gebruik van andere teststrips met deze meter kan onjuiste resultaten opleveren.

Belangrijke informatie over teststrips

- Het systeem heeft een bedrijfsbereik van 5°C–45°C (41°F–113°F).
- Bewaar de teststripverpakking op een koele, droge plaats tussen 1°C–30°C (33,8°F–86°F).
- Gebruik teststrips alleen binnen het bedrijfsbereik van het systeem.
- Houd uit direct zonlicht en warmte.
- Bewaar uw teststrips uitsluitend in hun originele flesje; doe ze nooit over in een ander flesje of een andere container.
- Bewaar individuele teststrips nooit buiten het flesje.
- Sluit het flesje direct goed af nadat u een teststrip eruit heeft gehaald.
- Met schone, droge handen mag u de teststrip overal aanraken bij het verwijderen uit het flesje of bij het plaatsen in de meter.
- Gebruik teststrips niet na de vervaldatum. Dit kan onjuiste resultaten veroorzaken.
- Buig, knip of wijzig teststrips niet.


Waarschuwing:
De dop of het flesje bevat droogmiddelen die schadelijk kunnen zijn bij inademing of inslikken en huid- of oogirritatie kunnen veroorzaken.

VitaeChek Steekapparaat

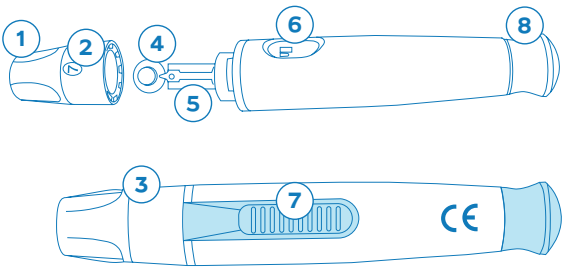

1. Verstelbare punt
2. Pijl
3. Steekapparaatkap
4. Lancetdop
5. Lancethouder
6. Triggerknop
7. Lancetwerper
8. Schuivende cilinder

VitaeChek Lancet



1. Beschermkap
2. Lancetpen

Uw meter instellen

Wanneer u de meter voor de eerste keer gebruikt, stel dan de parameters van de meter in.
Zet de meter uit en houd de “S”-knop ingedrukt om de instelmodus te openen.



Het jaar instellen

- Druk op de knop “M” en laat los om het jaar één voor één te verhogen totdat het juiste jaar verschijnt.
- Na het instellen van het jaar, druk op “S”; het maandcijfer begint automatisch te knipperen.



De maand instellen

- Druk op de knop “M” en laat los om de maand één voor één te verhogen totdat de juiste maand verschijnt.
- Na het instellen van de maand, druk op “S”; het dagcijfer begint automatisch te knipperen.



De dag instellen

- Druk op de knop “M” en laat los om de dag één voor één te verhogen totdat de juiste dag verschijnt.
- Na het instellen van de dag, druk op “S”; het uurcijfer begint automatisch te knipperen.



Het uur instellen

- Druk op de knop “M” en laat los om het uur één voor één te verhogen totdat het juiste uur verschijnt.
- Na het instellen van het uur, druk op “S”; het minutencijfer begint automatisch te knipperen.





De minuten instellen

- Druk op de knop “M” en laat los om de minuten één voor één te verhogen totdat de juiste minuten verschijnen.
- Na het instellen van de minuten, druk op “S”; het tijdsformaat verschijnt op het scherm.



OR



Het tijdsformaat instellen

- De meter kan de tijd weergeven in AM/PM (12-uurs) of 24:00 (24-uurs) formaat.
- Druk op de knop “M” en laat los om het gewenste formaat te selecteren. Met het gekozen tijdsformaat op het scherm, druk op “S”; het meeteenheidcijfer verschijnt.



OR



De meeteenheid instellen

- De meter kan testresultaten weergeven in milligram per deciliter (mg/dL) of millimol per liter (mmol/L).
- Houd de knoppen “S” en “M” 5 seconden ingedrukt om de gewenste meeteenheid te selecteren.
- Met de gekozen meeteenheid op het scherm, druk op “S” om de alarmklok in te stellen.



OR



De alarmklok instellen

- De meter kan een alarm instellen om u te herinneren aan het testmoment.
- Druk op “M” om de alarmfunctie te controleren.
- Als het alarm is ingeschakeld, druk op “S”; het tijdcijfer begint te knipperen.
- Voor het instellen van de tijd, volg stap 3 en 4. Na het instellen, druk op “S” om de instelmodus te verlaten.
- Als er geen alarm nodig is, druk op “S” om de instelmodus te verlaten.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth-vereisten

De Glucosemeter vereist een Bluetooth-apparaat met:

- Bluetooth 4.0 of hoger
- Android 6.0 of hoger
- iOS 10.0 of hoger

En werkt met:

- iPhone, iPad
- Android-telefoons en tablets

Voor het eerst gebruiken

1. Download de “Glucojoy” app via Google Play of de Apple Store.
2. Open de app op uw telefoon of tablet. Indien gevraagd, schakel Bluetooth in op uw apparaat. Dit kan via het Instellingen-menu van uw smartphone of tablet.
3. Maak een nieuw gebruikersaccount aan of log in met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.


Wanneer uw Glucosemeter succesvol is verbonden met uw smart-apparaat, stopt het “ ” -symbool met knipperen en blijft het zichtbaar. Raadpleeg de snelgids van de GlucoJoy-app voor meer informatie.

Uw bloedglucose testen


Het steekapparaat voorbereiden

Waarschuwing:


- Tijdens normaal gebruik kan een bloedglucosemeter of steekapparaat in contact komen met bloed. Alle onderdelen van de kit worden als biohazard beschouwd en kunnen mogelijk besmettelijke ziekten overdragen via bloed, zelfs nadat u schoonmaak- en desinfectieprocedures heeft uitgevoerd.
- De meter en het steekapparaat mogen nooit door meer dan één persoon worden gebruikt. Deel de meter en het steekapparaat niet met anderen, ook niet met familieleden, vanwege het risico op infecties door bloedoverdraagbare pathogenen.
- Het schoonmaken en desinfecteren van de meter en het steekapparaat vernietigt de meeste, maar niet noodzakelijk alle bloedoverdraagbare pathogenen.
- Als de meter door een tweede persoon wordt gebruikt om de gebruiker te assisteren bij het testen, dienen de meter en het steekapparaat voor gebruik door de tweede persoon te worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.
- Desinfecteer de meter en het steekapparaat voordat iemand anders ze hanteert. Laat niemand anders testen met de meter of het steekapparaat.
- Het is belangrijk om de meter en het steekapparaat schoon en gedesinfecteerd te houden. Raadpleeg Hoofdstuk Onderhoud voor instructies over het reinigen en desinfecteren van de meter en het steekapparaat.
- Was uw handen grondig voor en na het hanteren van de meter, het steekapparaat of de teststrips.
- U mag de lancetdop niet in het steekapparaat plaatsen terwijl u tegelijkertijd de vrijgaveknop indrukt of het steekapparaat vasthouden met de vrijgaveknop op een oppervlak zoals een tafel. Dit kan de lancet per ongeluk vrijgeven en letsel veroorzaken.




Schroef de kap van het steekapparaat los.




Steek een nieuwe lancet stevig in de lancethouder.



Houd de lancetnaalddop vast en draai deze voorzichtig van de lancet.




Plaats de dop op het steekapparaat. Vermijd het aanraken van de triggerknop.



Stel de diepte-instelling in. De aanduidingsmarkeringen geven 5 niveaus van huidpenetratie aan. Schakel de dop van het steekapparaat naar de gewenste stand.

Opmerking: Voor het selecteren van de beste diepte:

- 1–2 voor zachte of dunne huid. 3 voor gemiddelde huid
- 4–5 voor dikke of eeltige huid




Houd de dop van het steekapparaat met één hand vast. Trek met de andere hand langzaam de schuivende cilinder weg van de dop van het steekapparaat. U hoort een klik, wat aangeeft dat de lancethouder op zijn plaats is vergrendeld. Laat de schuivende cilinder los zodat deze terugkeert naar de oorspronkelijke positie.


Bloedafname



Was uw handen en de prikplaats met een alcoholdoekje of zeep en water. Spoel goed af en droog grondig.



Plaats het uiteinde van de verstelbare punt tegen de zijkant van de vinger. Druk op de triggerknop en til het steekapparaat vervolgens van de vinger nadat de prik is voltooid. Leg het steekapparaat opzij en wacht enkele seconden tot er een bloeddruppel verschijnt.




Knijp voorzichtig in uw vinger totdat u een ronde druppel bloed krijgt. Gooi de eerste druppel weg. Gebruik deze niet als het bloed uitgeveegd of lopend is. Veeg het gebied schoon en knijp voorzichtig een nieuwe druppel bloed, of prik een nieuwe plek.

Belangrijk:

- Gebruik alleen BS-602 teststrips.
- Zorg ervoor dat uw meter en teststrips ongeveer dezelfde temperatuur hebben voordat u test.
- Testen moet plaatsvinden binnen het bedrijfsbereik van 5°C – 45°C (41°F – 113°F).
- Voor de meest nauwkeurige resultaten, test bij kamertemperatuur van 20°C – 25°C (68°F – 77°F).
- Sluit de dop van het flesje direct na gebruik goed om besmetting en beschadiging te voorkomen.
- Bewaar ongebruikte teststrips uitsluitend in hun originele flesje.
- Open het flesje pas wanneer u een teststrip wilt verwijderen en een test wilt uitvoeren. Gebruik de teststrip direct na verwijdering uit het flesje.
- Plaats de gebruikte teststrip niet terug in het flesje na de test.
- Gebruik een teststrip niet opnieuw als er bloed of controlevloeistof op is aangebracht. Teststrips zijn alleen voor eenmalig gebruik.
- Noteer de eerste openingsdatum op het etiket van het flesje wanneer u het voor het eerst opent. Gooi het flesje 6 maanden na de eerste opening weg.

Testen



1. **Steek een teststrip in de meter terwijl deze uitgeschakeld is of in instel- of geheugenmodus, om de testmodus te activeren.**

Opmerking:
Als u de test niet binnen drie minuten start, schakelt de meter uit. Haal de ongebruikte teststrip eruit en steek deze opnieuw in de meter om opnieuw te starten.

Belangrijk:
De meter mag alleen worden gebruikt met BS-602 teststrips. Het gebruik van andere teststrips kan onjuiste resultaten opleveren.



2. Het scherm toont kort alle inhoud om te bevestigen dat het display correct werkt.

Opmerking:

- Als verschijnt, betekent dit dat de bedrijfstemperatuur buiten het bereik ligt. Plaats het systeem een half uur op kamertemperatuur en test opnieuw.
- Als verschijnt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij direct.



3. Het bloeddruppelsymbool knippert op het scherm.

- Uw meter is nu klaar om het bloedmonster toe te passen.




4. Monster aanbrengen

- Raak voorzichtig het kanaal aan de rand van de bloeddruppel.

Opmerking:

- Gooi de eerste druppel bloed weg. Veeg of kras de druppel niet met de teststrip.
- Breng geen extra bloed aan op de teststrip nadat u de druppel hebt verplaatst.
- Verplaats de teststrip niet in de meter tijdens een test.



5. Wacht tot het controlevenster volledig is gevuld

- De bloeddruppel wordt in het smalle kanaal gezogen en het controlevenster moet volledig gevuld zijn.
- Wanneer het controlevenster vol is, betekent dit dat u voldoende bloed heeft aangebracht. U kunt nu de teststrip van de bloeddruppel weghalen en wachten tot de meter aftelt van 5 tot 1, met één pieptoon die het einde van de test aangeeft.



6. Lees uw resultaat op de meter

- Na de meting toont de meter het bloedsuikerniveau samen met de meet-eenheid, de datum en tijd van de test. Bloedsuikerresultaten worden automatisch opgeslagen in het geheugen van de meter.



7. Geheugen wissen

- Als u het testresultaat niet wilt bewaren, druk tegelijkertijd op de knoppen “S” en “M” om het te verwijderen. Nadat het geheugen is gewist, toont de meter “dEL” en schakelt automatisch uit.



8. Schakel uw meter uit

- Druk voorzichtig op de uitwerpknop om de teststrip automatisch uit de meter te verwijderen, of verwijder de teststrip handmatig. De meter schakelt vervolgens automatisch uit. Ga voorzichtig om met de gebruikte teststrip.

Onverwachte testresultaten interpreteren

De meter kan bloedsuikerconcentraties van 0,5 tot 33,3 mmol/L (9 tot 600 mg/dL) nauwkeurig meten.

Verwachte bloedsuikerwaarden [1, 2, 3]:

Tijd	Normaal bloedsuikerbereik
Voor ontbijt	3.9–5.8 mmol/L 70–105 mg/dL
Voor lunch of diner	3.9–6.1 mmol/L 70–110 mg/dL
1 uur na maaltijd	≤8.9 mmol/L less than 160 mg/dL
2 uur na maaltijd	≤ 6.7 mmol/L less than 120 mg/dL
Tussen 2:00 en 4:00 uur	≥ 3.9 mmol/L Greater than 70 mg/dL

Bronnen:

1. Clin Chem 51, 2005:1573–1576
2. Stedmans Medical Dictionary, 27e editie, 2000:2802
3. American Diabetes Association: Standard of Medical Care in Diabetes 2019, Vol. 39

Raadpleeg de volgende waarschuwingen wanneer uw testresultaten lager of hoger zijn dan verwacht.



1. **Lage glucosewaarden**
   Als uw testresultaat lager is dan 0,5 mmol/L (9 mg/dL), verschijnt Lo op het scherm van de meter.

- **Lo-weergave met symptomen**
  Als u een Lo-weergave krijgt en symptomen ervaart zoals zwakte, zweten, nervositeit, hoofdpijn of verwarring, volg dan de aanbevelingen van uw arts voor de behandeling van hypoglykemie.
- **Lo-weergave zonder symptomen**
  Als u een Lo-weergave krijgt maar geen symptomen van lage bloedsuiker ervaart, test dan opnieuw met een nieuwe teststrip op uw vinger.

  Als u nog steeds een Lo-weergave krijgt, volg dan de aanbevelingen van uw arts voor de behandeling van hypoglykemie.



2. **Hoge glucosewaarden**
   Als uw testresultaat hoger is dan 33,3 mmol/L (600 mg/dL), verschijnt HI op het scherm.

- **HI-weergave met symptomen**
  Als u symptomen ervaart zoals vermoeidheid, dorst, veel plassen of wazig zicht, volg dan de aanbevelingen van uw arts voor de behandeling van hyperglykemie.
- **HI-weergave zonder symptomen**
  Als u een HI-weergave krijgt maar geen symptomen van hoge bloedsuiker ervaart, test dan opnieuw met een nieuwe teststrip.
  Als u nog steeds een HI-weergave krijgt, volg dan de aanbevelingen van uw arts voor de behandeling van hyperglykemie.

3. **Ongebruikelijke hematocriet**
   Een te hoge hematocriet (boven 70%) kan onjuiste resultaten veroorzaken.
   Neem contact op met uw arts om uw hematocrietwaarde te bepalen.

Uw meterresultaat vergelijken met een laboratoriumresultaat

De resultaten van de VitaeChek G1 Pro meter zijn plasma-equivalent. Deze methode helpt u en uw zorgverlener om uw meterresultaten te vergelijken met laboratoriumtestresultaten. Zowel het testresultaat van de VitaeChek G1 Pro meter als de laboratoriumtestresultaten worden weergegeven in plasma-equivalente eenheden.

Uw bloedsuikermeterresultaat kan echter afwijken van het laboratoriumresultaat door normale variaties. Resultaten van uw meter kunnen beïnvloed worden door factoren en omstandigheden die laboratoriumresultaten niet op dezelfde manier beïnvloeden.

- Als uw bloedsuiker lager is dan 5,55 mmol/L (100 mg/dL), zouden uw resultaten over het algemeen binnen ±0,83 mmol/L (±15 mg/dL) van het laboratoriumresultaat moeten liggen.
- Als uw bloedsuiker gelijk aan of hoger is dan 5,55 mmol/L (100 mg/dL), zouden uw resultaten over het algemeen binnen ±15% van het laboratoriumresultaat moeten liggen.

Om de kans op een nauwkeurige vergelijking tussen meter- en laboratoriumresultaten te maximaliseren, volg een paar basisrichtlijnen:

Voor u naar het laboratorium gaat:

- Voer een controle-oplossingstest uit om te controleren of de meter correct werkt.
- Eet minstens acht uur niet voordat u uw bloedsuiker test.

Tijdens het laboratoriumbezoek:

- Voer uw meting met de meter binnen 15 minuten na de laboratoriumtest uit.
- Gebruik vers capillair bloed verkregen uit de vingertop, veneus bloed of neonataal bloed.
- Volg alle instructies in deze gebruikershandleiding om een bloedsuikermeting met uw meter uit te voeren.

Geheugen en gemiddelden

Opslaan van bloedsuiker- en controletestresultaten

De meter slaat automatisch tot 360 bloedsuikertestresultaten op, inclusief tijd en datum van de test en eventuele testmarkeringen. Resultaten kunnen op elk moment worden bekeken. Testresultaten worden opgeslagen van nieuwste naar oudste, dus stel tijd en datum correct in op de meter. Het correct instellen van tijd en datum helpt bij de juiste interpretatie van opgeslagen bloedsuikerwaarden.

1. **Geheugenmodus openen**
   Begin met de meter uitgeschakeld (geen teststrip geplaatst). Druk op de "M"-knop en laat los om de geheugenmodus te openen.



2. **Vorige resultaten bekijken in volgorde**
   - Druk op de "M"-knop en laat los om vooruit te scrollen door alle resultaten.
   - Het meest recente resultaat wordt eerst weergegeven.



Opmerking:
Als er geen testresultaten zijn opgeslagen, toont de meter "- - -" voor een paar seconden en schakelt vervolgens automatisch uit.



3. **7-, 14- en 28-daags gemiddelde bekijken**
   - Druk op de "S"-knop en laat los om het gemiddelde waarde scherm te openen.
   - Het eerste geheugenweergavescherm dat u ziet, toont uw 7-daags gemiddelde.
   - Dit gemiddelde omvat alle metingen van de afgelopen dagen.
   - n = geeft het aantal resultaten aan dat in uw gemiddelde is opgenomen.



4. **Het hele geheugen wissen**
   - Houd de "S"-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
   - Nadat het geheugen is gewist, toont de meter "dEL" en schakelt vervolgens automatisch uit.

5. **Afsluiten**
   Houd in de geheugenmodus de "M"-knop enkele seconden ingedrukt totdat de meter uitschakelt.

Controle-oplossingstest

Wanneer een controletest uitvoeren

De controle-oplossing bevat een specifieke hoeveelheid glucose en wordt gebruikt om te controleren of de meter en teststrips correct werken.

Voer een controle-oplossingstest uit:


- Telkens wanneer u een nieuw flesje teststrips opent.
- Telkens wanneer u wilt controleren of u correct test.
- Als u vermoedt dat de meter of teststrips niet goed werken.
- Als u herhaaldelijk onverwachte bloedsuikerwaarden heeft gekregen.
- Als u de meter heeft laten vallen of beschadigd.
- Als u het teststripflesje open heeft laten staan of denkt dat de teststrips beschadigd zijn.
- Als de teststrips zijn bewaard bij extreme temperaturen en/of vochtigheid.
- Als uw testresultaat niet overeenkomt met hoe u zich voelt.

Opmerking:

- Gebruik alleen de VitaeChek CS-201 controle-oplossing.
- Sluit het flesje controle-oplossing na gebruik goed af.
- Noteer de datum van eerste opening op het etiket van het flesje.
- De controle-oplossing moet worden weggegooid 3 maanden na de eerste opening of op de vervaldatum op het etiket, afhankelijk van wat het eerst komt.
- Gebruik geen controle-oplossing die de vervaldatum of weggooidatum heeft overschreden.
- Raadpleeg het etiket van de controle-oplossing voor de opslagvoorwaarden.
- De controle-oplossing kan vlekken veroorzaken op stoffen. Verwijder vlekken door te wassen met zeep en water.

Waarschuwing:
Niet inslikken. Controle-oplossing is niet voor menselijke consumptie. Breng de controle-oplossing niet aan op de huid of ogen, dit kan irritatie veroorzaken.

Een controletest uitvoeren




1. **Steek een teststrip in om de meter aan te zetten**




2. **Systeemcontrolescherm**
   Elke keer dat de meter wordt ingeschakeld, verschijnt dit scherm kort zodat u kunt controleren of het display correct werkt.



3. **Het bloeddruppelsymbool knippert op het scherm.**
   Uw meter is nu klaar om een bloedmonster toe te passen.



4. **Controleer de vervaldatum voordat u een controle-oplossingstest uitvoert.**
   Gebruik deze niet als de oplossing is vervallen. Noteer de vervaldatum op het flesje controle-oplossing bij de eerste opening.




5. **Schud het flesje controle-oplossing voor elke test.**




6. Verwijder de dop en knijp in het flesje om de eerste druppel weg te gooien.

- Veeg vervolgens de tuit schoon met een schone tissue of doek.
- Houd het flesje ondersteboven en knijp voorzichtig om een hangende druppel te vormen.



7. Raak de hangende druppel van de controle-oplossing aan en houd deze vast op het punt waar het smalle kanaal de BOVENRAND van de teststrip ontmoet.

- Zorg ervoor dat het controlevenster volledig gevuld wordt.
- Breng de controle-oplossing niet aan op het platte vlak van de teststrip.





8. Resultaat aflezen op de meter

- Wanneer het controlevenster vol is, telt de meter af van 5 tot 1.
  Na de meting toont de meter het bloedsuikerniveau, samen met de meet-eenheid, de datum en tijd.
- De resultaten worden automatisch opgeslagen in het geheugen van de meter.

Begrijpen van controletestresultaten buiten bereik





Vergelijk het resultaat dat op de meter wordt weergegeven met het controle-oplossingbereik dat op het flesje teststrips staat afgedrukt. Elke controle-oplossing heeft een ander bereik.

Resultaten buiten bereik kunnen worden veroorzaakt door:

- Het niet volgen van de instructies zoals beschreven in stap 1–6
- Verlopen of verontreinigde controle-oplossing
- Verlopen of beschadigde teststrip
- Gebruik van een teststrip of controle-oplossing die de weggooidatum heeft overschreden
- Een probleem met de meter

Waarschuwing:
Het controle-oplossingbereik dat op het flesje teststrips staat afgedrukt, is alleen voor VitaeChek Controle-oplossing. Het is niet het aanbevolen bereik voor uw bloedsuikerniveau.

Waarschuwing:
Als u blijvend controle-oplossingresultaten krijgt die buiten het bereik van het teststripflesje vallen, gebruik de meter, teststrips of controle-oplossing niet. Neem contact op met de leverancier.



9. Geheugen wissen

- Houd de "S"-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Nadat het geheugen is gewist, toont de meter "dEL" en schakelt automatisch uit.



10. Schakel uw meter uit


Druk voorzichtig op de uitwerpknop om de teststrip automatisch uit de meter te verwijderen, of verwijder de teststrip met de hand. De meter schakelt vervolgens automatisch uit. Ga voorzichtig om met de gebruikte teststrip.

Onderhoud


De batterij vervangen

Uw meter wordt geleverd met twee AAA-batterijen, alkaline. De batterij levert voldoende stroom om ongeveer 1000 tests uit te voeren. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt het batterijsymbool " " op het scherm totdat u de batterij vervangt.


Belangrijk:
Wanneer dit symbool verschijnt, dient u de batterij direct te vervangen.



1. Zet de meter uit en open het batterijvak.



2. Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen.



3. Plaats het batterijvak terug totdat het vergrendelt.

4. Controleer uw meterinstellingen. Het vervangen van de batterij beïnvloedt uw opgeslagen resultaten niet, maar u moet mogelijk uw meterinstellingen opnieuw configureren. Raadpleeg hiervoor de sectie "Uw meter instellen".

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale voorschriften.

Meteronderhoud

Voorkom dat vuil, stof, bloed, controle-oplossing, water of andere vloeistoffen in de teststripopening van de meter komen.

BELANGRIJK:
Dompel de meter nooit onder in water of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot onjuiste metingen of storingen van de meter.

Uw systeem opbergen

- Berg uw meter, teststrips, controle-oplossing en andere items in de draagtas na elk gebruik.
- Bewaar alle items op een koele, droge plaats.
- Opslagvoorwaarden:
  - Teststrips en controle-oplossing: 1°C–30°C (33,8°F–86°F)
  - Meter en andere items: -20°C–55°C (-4°F–131°F)
- Niet koelen.
- Houd alle items uit direct zonlicht en warmte.
- Sluit de dop van het teststripflesje en/of controle-oplossingflesje direct na gebruik goed om besmetting of beschadiging te voorkomen.
- Bewaar teststrips altijd in hun originele flesje.

Controleren op vervaldatum of beschadiging

- De vervaldata van teststrips en controle-oplossingen staan op het etiket van het flesje.
- Wanneer u een nieuw flesje teststrips of controle-oplossing opent, noteer dan de weggooidatum op het etiket.
- Raadpleeg het flesje teststrips of controle-oplossing voor specifieke instructies over het bepalen van de weggooidatum.

Reinigen en desinfecteren

- Reinigen en desinfecteren zijn verschillend, beide moeten worden uitgevoerd.
- Reinigen is een onderdeel van normaal onderhoud en moet worden uitgevoerd voor desinfectie, maar reinigen doodt geen ziektekiemen.
- Desinfecteren is een belangrijke manier om uw blootstelling aan ziekten te verminderen.
- Ook als u de enige gebruiker bent, aanbevelen wij periodiek te desinfecteren.
- Wanneer u anderen helpt bij het meten van hun bloedsuiker met de meter, desinfecteer de meter of draag handschoenen om uzelf te beschermen.

Uw meter en prikapparaat reinigen

- Veeg de buitenkant van de meter en het prikapparaat af met een zachte doek die is vochtig gemaakt met water en milde zeep.
- Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen.
- Voorkom dat vloeistoffen, vuil, stof, bloed of controle-oplossing via de teststripopening in de meter komen.
- Spuit nooit reinigingsmiddel direct op de meter en dompel de meter niet onder in vloeistof.
- Dompel het prikapparaat niet onder in vloeistof.

Uw meter en prikapparaat desinfecteren

- De meter en het prikapparaat moeten periodiek worden gedesinfecteerd.
- Reinig altijd uw meter en prikapparaat voorafgaand aan desinfectie.
- Om een desinfectieoplossing te bereiden:
  - Meng 1 deel huishoudbleekmiddel met 9 delen water.
- Houd de meter met de teststripopening naar beneden.
- Gebruik een zachte doek die is vochtig gemaakt met de bleekoplossing om de buitenkant van de meter en het prikapparaat af te vegen.
  - Knijp overtollige vloeistof uit voordat u veegt.
- Na het afvegen, bedek het te desinfecteren oppervlak met de vochtige doek gedurende 1 minuut.
- Veeg daarna opnieuw met een schone, zachte doek en laat de oppervlakken volledig aan de lucht drogen.
- Was uw handen grondig met zeep en water nadat u de meter en het prikapparaat heeft gebruikt.

Probleemoplossing



Het systeemcontrole kan zijn mislukt
Verwijder de batterij en plaats deze 30 seconden later opnieuw. Als het nog steeds niet werkt, neem contact op met de leverancier.



De teststrip kan gebruikt of beschadigd zijn
Zorg ervoor dat het stripmodel correct is en test opnieuw met een nieuwe strip.




Het monster is aangebracht voordat de meter klaar was
Herhaal de test met een nieuwe strip. Breng het bloed aan nadat het “ ” -symbool op het scherm knippert.



De teststrip kan zijn verplaatst tijdens de test of de meetgegevens zijn instabiel
Test opnieuw met een nieuwe strip. Zorg ervoor dat de manier van monsterafname correct is en dat de teststrip tijdens de test niet wordt verplaatst.



Probleem met de stripcontrole
Zorg ervoor dat het stripmodel correct is en test opnieuw met een nieuwe strip.



Batterij bijna leeg
Vervang de batterij binnenkort.



De meter bevindt zich buiten het bedrijfs-temperatuurbereik
Plaats het systeem 30 minuten in een geschikte omgeving voordat u opnieuw test.

Meter gaat niet naar testmodus na het plaatsen van een teststrip	
Waarschijnlijke oorzaak	**Wat te doen**
Batterij bijna leeg	Vervang de batterij (en stel zo nodig de datum en tijd opnieuw in).
De batterij is verkeerd geplaatst of er zit geen batterij in de meter	Controleer of de batterij correct is geplaatst.
Teststrip is ondersteboven of niet volledig in de meter geplaatst	Controleer of de teststrip correct is geplaatst.
Defecte meter of teststrips	Neem contact op met de leverancier.
Bloed of vreemde voorwerpen in de teststripopening	Neem contact op met de leverancier.

Test start niet na het aanbrengen van een bloedmonster	
Waarschijnlijke oorzaak	**Wat te doen**
Defecte teststrip	Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
Monster aangebracht nadat de meter is uitgeschakeld	Verwijder de teststrip en herhaal de test met een nieuwe teststrip. Wacht totdat u de bloed- en teststrip-symbolen op het scherm ziet voordat u het bloedmonster aanbrengt.
Defecte meter of teststrips	Neem contact op met de leverancier.

Technische informatie

Specificaties

Productbeschrijving	G1 Pro Bloedsuikermonitoringsysteem
Testmethode	Glucose-dehydrogenase biosensor
Meetbereik	0,5–33,3 mmol/L (9–600 mg/dL)
Monster	Vers capillair volbloed, veneus bloed, neonataal bloed
Monstergrootte	Ongeveer 0,6 microliter
Responstijd	5 seconden
Kalibratie	Plasma-equivalente glucosewaarden
Batterij	2x AAA alkalinebatterijen
Batterijduur	Ongeveer 1.000 tests
Meet-eenheid	mmol/L of mg/dL; schakelbaar
Geheugen	360 bloedsuikerresultaten met datum en tijd
Afmetingen	90 × 61 × 23,6 mm (L × B × H)
LCD-grootte	35,4 × 30,9 mm (L × H)
Gewicht	Ongeveer 51,6 g, exclusief batterijen
Bedrijfsomgeving	5°C–45°C (41°F–113°F)
	10–90% RV (niet-condenserend)
Opslagomgeving van de meter	-20°C–55°C (-4°F–131°F)
	10–95 % de humedad relativa (sin condensación)
Opslagomgeving van de teststrips	1°C–30°C (33,8°F–86°F)
Hoogte	Tot 10.000 ft (3.048 meter) boven zeeniveau
Hematocriet	0%–70%
Houdbaarheid	Drie jaar

Elektromagnetische compatibiliteit

Deze meter voldoet aan de eisen voor elektromagnetische immuniteit volgens standaard EN ISO 15197:2015. De gekozen basis voor de immuniteitstest tegen elektrostatische ontlading was de basale standaard EN 61326:2013. De meter voldoet aan de elektromagnetische emissie-eisen volgens standaard EN 61326. De elektromagnetische emissie is dus laag. Storingen van de meter op andere elektrisch aangedreven apparaten worden niet verwacht.

Afvoeren van de meter, teststrips, lancetten en batterijen

Waarschuwing:

- Elk product dat in contact komt met bloed wordt als verontreinigd (potentieel besmettelijk) beschouwd.
- Tijdens normaal testen kan elke bloedsuikermeter in contact komen met bloed.
- Prikapparaten kunnen ook worden beschouwd als scherpe voorwerpen. Raadpleeg voor het afvoeren van scherpe voorwerpen de lokale regelgeving.

Raadpleeg wetten of verordeningen met betrekking tot het afvoeren van scherpe en/of verontreinigde producten. Neem contact op met uw lokale gezondheidsdienst of andere bevoegde autoriteiten voor de juiste verwerking en afvoer van gebruikte meters, gebruikte teststrips, gebruikte lancetten en gebruikte batterijen.

Houd rekening met de volgende punten bij het afvoeren van gebruikte testmaterialen:

- Overweeg recycling van meters en batterijen bij een geschikte faciliteit. Wees ervan bewust dat de meter potentieel gevaarlijk elektronisch afval (e-scrap) is en dienovereenkomstig moet worden afgevoerd. De batterijen zijn ook potentieel gevaarlijk en moeten op de juiste manier worden verwijderd.
- Desinfecteer de meter voordat u deze recyclet of weggooit.
  - 29 CFR 1910.1030 – Blood-borne pathogens
  - Richtlijn 2002/96/EG – Richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

Garantie

Beperkte garantie van 2 jaar

De meter wordt 2 jaar gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. Als de meter niet correct functioneert door defecte onderdelen of slechte afwerking, zullen wij deze gratis repareren of vervangen. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik. De batterij is niet inbegrepen in de garantie.

Traceerbaarheid

De traceerbaarheid van de controle-oplossing is gerelateerd aan de YSI2500 Biochemistry Analyzer. De YSI2500 Biochemistry Analyzer is de referentiemethode die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de glucosewaarden verkregen met het systeem te beoordelen.

De glucosewaarde is traceerbaar naar het National Institute of Standards and Technology (NIST) Standard Reference Material (SRM) 917c (D-Glucose).

Concentratie: 200 mg/dL

Performance characteristics

The performance of the system has been evaluated both in laboratory and in clinical tests.

Range:
The display range of the meter is 0.5 mmol/L to 33.3 mmol/L (9 mg/dL to 600 mg/dL). “HI” and “Lo” messages indicate results outside of this range.

Accuracy:
The accuracy of the system was assessed by comparing blood glucose results from fresh capillary whole blood obtained by patients with those obtained using a Glucose Analyzer, a laboratory instrument.

Tabel 1

Systeempreciezeresultaten voor glucoseconcentratie <5,55 mmol/L (100 mg/dL)

Binnen ±0.28 mmol/L (Binnen ±5 mg/dL)	Binnen ±0.56 mmol/L (Binnen ±10 mg/dL)	Binnen ±0.83 mmol/L (Binnen ±15 mg/dL)
118/150 (78.7%)	150/150 (100%)	150/150 (100%)

Wanneer de bloedsuiker onder 5,55 mmol/L (100 mg/dL) ligt, moeten 100% van de gemeten glucosewaarden binnen ±0,83 mmol/L (±15 mg/dL) van het laboratoriumresultaat vallen.

Tabel 2

Systeempreciezeresultaten voor glucoseconcentratie ≥5,55 mmol/L (100 mg/dL)

Binnen ±5%	Binnen ±10%	Binnen ±15%
277/450 (61.6%)	400/450 (88.9%)	446/450 (99.1%)

Wanneer de bloedsuiker gelijk aan of hoger is dan 5,55 mmol/L (100 mg/dL), moeten 99,1% van de gemeten glucosewaarden binnen ±15% van het laboratoriumresultaat vallen.

Tabel 3

Systeempreciezeresultaten voor glucose tussen 0,5 mmol/L (9 mg/dL) en 33,3 mmol/L (600 mg/dL)

Binnen ±0.83 mmol/L or ±15% (Binnen ±15 mg/dL or ±15%)
596/600 (99.3%)

Deze studie toont aan dat het systeem goed overeenkomt met een laboratoriummethode en voldoet aan de minimale prestatiecriteria zoals gedefinieerd in EN ISO 15197:2015.

Precisie:
De herhaalbaarheidsevaluatie is uitgevoerd met veneus volbloed en de intermediaire precisie-evaluatie is uitgevoerd met controle-oplossingen.

Intermediaire precisie	Controle-oplossing gemiddeld 2,2 mmol/L SD=0,08 mmol/L Controle-oplossing gemiddeld 4,9 mmol/L SD=0,14 mmol/L Controle-oplossing gemiddeld 7,2 mmol/L CV=2,0% Controle-oplossing gemiddeld 11,0 mmol/L CV=1,8% Controle-oplossing gemiddeld 18,1 mmol/L CV=1,4%
Herhaalbaarheid	Bloed gemiddeld 2,6 mmol/L SD=0,11 mmol/L Bloed gemiddeld 4,7 mmol/L SD=0,2 mmol/L Bloed gemiddeld 7,4 mmol/L CV=2,3% Bloed gemiddeld 11,5 mmol/L CV=2,6% Bloed gemiddeld 20,5 mmol/L CV=1,6%

Om de kans op een nauwkeurige vergelijking tussen meter- en laboratoriumresultaten te maximaliseren, volgt u een paar basisrichtlijnen:

Voor het bezoek aan het laboratorium

- Voer een controle-oplossingstest uit om te controleren of de meter correct werkt.
- Eet minimaal acht uur niet voordat u uw bloed test.
- Neem uw meter mee naar het laboratorium.

Tijdens het laboratoriumbezoek

- Voer de meting met uw meter uit binnen 15 minuten na de laboratoriumtest.
- Gebruik vers capillair bloed van de vingertop, veneus bloed, of neonaat bloed.
- Volg alle instructies in deze gebruikershandleiding voor het uitvoeren van een bloedsuikertest met uw meter.

Symboolindex

	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel
	Serienummer
	Waarschuwing / Voorzichtig
	Batchcode
	Fabrikant
	Bevat voldoende voor < n > tests
	Opslagtemperatuurbeperkingen
	Niet hergebruiken
	Te gebruiken tot
	Beperking opslagvochtigheid

CE XXXX	Het product voldoet aan... van de EC-richtlijn IVDD (98/79/EC) voor in vitro diagnostische medische hulpmiddelen. "xxxx" is het identificatienummer van de aangemelde instantie.
	Droog bewaren
	Gelieve afval af te voeren volgens de lokale regelgeving
	Gelijkstroom (DC)
EC REP	Europees gemachtigde vertegenwoordiger

Appendix

Gebruik van vingerprikapparaten bij meer dan één persoon brengt het risico van overdracht van bloedoverdraagbare pathogenen met zich mee:
Initial Communication, (2010) http:/www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm Geraadpleegd op 8 juni 2011

CDC Clinical Reminder:
"Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens," (2010) http:/www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html. Geraadpleegd op 8 juni 2011

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC):
William A. Rutala, Ph.D., M.P.H., en David J. Weber, M.D., M.P.H., Centers for Disease Control and Prevention, 2008. "Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Atlanta."

Beheer je bloedsuiker:
scan en download de applicatie.

Sejoy Biomedical Co., Ltd.

Area C, Building 2, No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 11100, Zhejiang P.R. China

www.vitaehealths.com

CE 0197

Distributed in Europe by Vitae Health Solutions Via Perugino 6, Parabiago, Milano, Italy
TEL: +39 3293322284
E-Mail: info@vitaehealths.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp.Gmbh (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Vitae Chek

Europe

Distributed by: Vitae Health Solutions Via Bruno Buozzi, Sesto San Giovanni. Milano, Italy
+39 351 933 5656
info@vitaehealths.com

www.vitachek.com

Meditegs
Medical Tech. Solution

Africa

Distributed by: Meditegs Sarl
Bepanda Americain Building – Douala – Cameroon
+237 6 93 59 45 63 / 678834330
info@meditegs.com

www.cameroun.vitaechek.com